


# Algorithme 0–3 heures\* pour l'interprétation des résultats du test Dimension Vista® TNIH

\*avec 99<sup>e</sup> percentile combiné (femmes et hommes)  
sur plasma hépariné

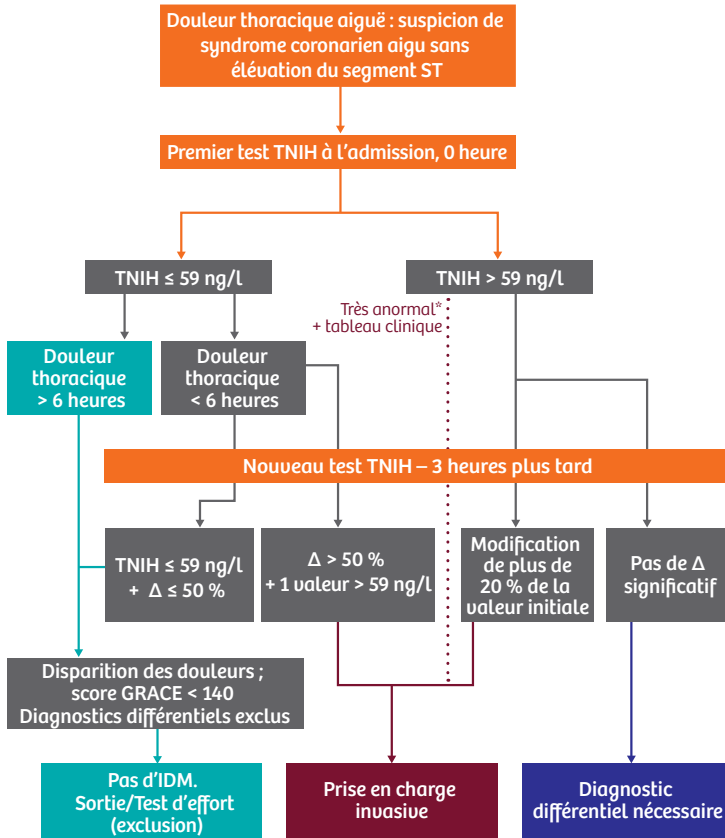

\*Au moins 5 fois le 99<sup>e</sup> percentile soit 295 ng/L à l'admission

TNIH : High Sensitivity Troponin I

IDM : infarctus aigu du myocarde

Références :

Roffi M, et al. Eur Heart J. 2016;37:267-315.

Thygesen K, et al. Eur Heart J. 2012;33:2551-67.

Thygesen K, et al. Circulation. 2018;138:e618-e651.

Amsterdam EA, et al. Circulation. 2014;130:e344-426.

Dimension Vista et le test High-Sensitivity Troponin I (TNIH) Mandataire : Siemens Healthcare Diagnostics Manufacturing Limited, Chapel Lane, Swords, Co Dublin, Ireland // Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation de l'instrument et la notice d'utilisation du test

**SIEMENS**  
**Healthineers**